

serf*extremity*

***CATALOGUE
PRODUITS***

www.serf.fr



SOMMAIRE

VIS F.A.S.T.® Ø 2.3
4

VIS F.A.S.T.® Ø 2.7
5

VIS F.A.S.T.® Ø 3.2
6

VIS F.A.S.T.® Ø 4.2
7

VIS F.A.S.T.® Ø 6.5
8

VIS SÉCABLE
9

ANCILLAIRES VIS F.A.S.T.®
10-11

ANCILLAIRE D'EXTRACTION
12

FRAISES PERCUTANÉES
13

TOE F.A.S.T.®
14

ANCILLAIRE TOE F.A.S.T.®
15

PLAQUES F.A.S.T.®
16-18

ANCILLAIRE PLAQUES F.A.S.T.®
19


AGRAFES DE VARISATION
20

ANCILLAIRES
AGRAFES DE VARISATION
21

NOTICES D'INSTRUCTION
22

F.A.S.T.®

Ø 2.3



La vis F.A.S.T.® Ø 2.3, est une vis de petit diamètre permettant la synthèse de petits fragments osseux. Elles sont guidées par une broche Ø 1.0 L 80 mm.



UTILISATION

Traitement de l'hallux valgus, métatarsalgie et synthèse de petits fragments osseux.

MATÉRIAU

Titane TA6V ELI ISO5832-3

COMPRESSION

LIBELLÉ	GST
FAST	3663165...
Ø 2.3 L 10 MM	...001946
Ø 2.3 L 12 MM	...001953
Ø 2.3 L 14 MM	...001960
Ø 2.3 L 16 MM	...001977
Ø 2.3 L 18 MM	...001984
Ø 2.3 L 20 MM	...001991
Ø 2.3 L 22 MM	...002004
Ø 2.3 L 24 MM	...002011
Ø 2.3 L 26 MM	...002028
Ø 2.3 L 28 MM	...002035
Ø 2.3 L 30 MM	...002042

INSTRUMENTS ASSOCIÉS

KIT F.A.S.T.® AVANT MEDIO PIED : VASEAMP

Poignée à encliquetage AO



Jauge broche :
Recto pour broche 80 mm




Broche Ø 1 - L 80 mm



Tournevis Torx T7



Fraise à chambrer Ø 2.3



F.A.S.T.®
Ø 2.7

Les vis F.A.S.T.® Ø 2.7 se déclinent en 3 versions : Compression, Neutralisation et Biseautée. Elles permettent de répondre à un grand nombre de techniques chirurgicales de l'avant pied.

Les vis biseautées présentent l'avantage d'avoir un ancrage osseux sur le pourtour de la tête tout en étant atromatique pour les tissus environnant lors d'une insertion oblique.

Elles sont guidées par une broche Ø 1.2 L 120 mm.

COMPRESSION		NEUTRALISATION		BISEAUTÉE	
LIBELLÉ	GS1	LIBELLÉ	GS1	LIBELLÉ	GS
FAST	3663165...	FAST	3663165...	FAST	3663165...
Ø 2.7 L 12 MM	...003728	Ø 2.7 L 14 MM	...002394	Ø 2.7 L 14 MM	...002257
Ø 2.7 L 14 MM	...002165	Ø 2.7 L 16 MM	...002400	Ø 2.7 L 16 MM	...002264
Ø 2.7 L 16 MM	...002172	Ø 2.7 L 18 MM	...002417	Ø 2.7 L 18 MM	...002271
Ø 2.7 L 18 MM	...002189	Ø 2.7 L 20 MM	...002424	Ø 2.7 L 20 MM	...002288
Ø 2.7 L 20 MM	...002196	Ø 2.7 L 22 MM	...002431	Ø 2.7 L 22 MM	...002295
Ø 2.7 L 22 MM	...002202	Ø 2.7 L 24 MM	...002448	Ø 2.7 L 24 MM	...002301
Ø 2.7 L 24 MM	...002219	Ø 2.7 L 26 MM	...002455	Ø 2.7 L 26 MM	...002318
Ø 2.7 L 26 MM	...002226	Ø 2.7 L 28 MM	...002462	Ø 2.7 L 28 MM	...002325
Ø 2.7 L 28 MM	...002233	Ø 2.7 L 30 MM	...002479	Ø 2.7 L 30 MM	...002332
Ø 2.7 L 30 MM	...002240			Ø 2.7 L 32 MM	...002349
				Ø 2.7 L 34 MM	...002356
				Ø 2.7 L 36 MM	...002363
				Ø 2.7 L 38 MM	...002370
				Ø 2.7 L 40 MM	...002387



UTILISATION

Traitement de l'hallux valgus (conventionnel), synthèse de fragments osseux.

MATÉRIAU

Titane TA6V ELI ISO5832-3

INSTRUMENTS ASSOCIÉS

KIT F.A.S.T.® AVANT MEDIO PIED : VASEAMP

Poignée à encliquetage AO




Jauge broche :
Verso pour broche 120 mm



Broche Ø 1,2 - L 120 mm



Tournevis Torx T8



Fraise à chambrer Ø 2.7

F.A.S.T.®

Ø 3.2





UTILISATION

Traitement de l'hallux valgus (percutanée), arthrodèse MTP, synthèse de fragments osseux.

MATÉRIAU

Titane TA6V ELI ISO5832-3



Les vis F.A.S.T.® Ø 3.2 se déclinent en 2 versions : Compression et Biseautée. La vis biseautée permet de répondre à la technique percutanée F.A.S.T.®. Ces vis sont guidées par une broche Ø 1,2 L 120 mm.

COMPRESSION

LIBELLÉ	GSI	LIBELLÉ	GSI
FAST	3663165...	FAST	3663165...
Ø 3.2 L 14 MM	...002486	Ø 3.2 L 16 MM	...003742
Ø 3.2 L 16 MM	...002493	Ø 3.2 L 18 MM	...003735
Ø 3.2 L 18 MM	...002509	Ø 3.2 L 20 MM	...003360
Ø 3.2 L 20 MM	...002516	Ø 3.2 L 22 MM	...002622
Ø 3.2 L 22 MM	...002523	Ø 3.2 L 24 MM	...002639
Ø 3.2 L 24 MM	...002530	Ø 3.2 L 26 MM	...002646
Ø 3.2 L 26 MM	...002547	Ø 3.2 L 28 MM	...002653
Ø 3.2 L 28 MM	...002554	Ø 3.2 L 30 MM	...002660
Ø 3.2 L 30 MM	...002561	Ø 3.2 L 32 MM	...002677
Ø 3.2 L 32 MM	...002578	Ø 3.2 L 34 MM	...002684
Ø 3.2 L 34 MM	...002585	Ø 3.2 L 36 MM	...002691
Ø 3.2 L 36 MM	...002592	Ø 3.2 L 38 MM	...002707
Ø 3.2 L 38 MM	...002608	Ø 3.2 L 40 MM	...002714
Ø 3.2 L 40 MM	...002615	Ø 3.2 L 42 MM	...002721

BISEAUTÉE

Ø 3.2 L 44 MM	...002738
Ø 3.2 L 46 MM	...002745
Ø 3.2 L 48 MM	...002752
Ø 3.2 L 50 MM	...002769
Ø 3.2 L 52 MM	...002776
Ø 3.2 L 54 MM	...002783
Ø 3.2 L 56 MM	...002790
Ø 3.2 L 58 MM	...002806
Ø 3.2 L 60 MM	...002813

INSTRUMENTS ASSOCIÉS

KIT F.A.S.T.® AVANT MIEDIO PIED : VASEAMP / KIT F.A.S.T.® MIEDIO ARRIÈRE PIED : VASEMAP

Poignée à encliquetage AO



Jauge broche :
Recto pour broche 120 mm




Broche Ø 1.2 - L 120 mm



Tournevis Torx T10



Fraise à chambrer Ø 3.2



F.A.S.T.®
Ø 4.2

La vis F.A.S.T.® Ø 4.2 est indiquée pour les indications du médio pied. Elles sont guidées par une broche Ø 1,2 L 120 mm.

COMPRESSION

LIBELLÉ	GS1
FAST	3663165...
Ø 4.2 L 30 MM	...002967
Ø 4.2 L 32 MM	...002974
Ø 4.2 L 34 MM	...002981
Ø 4.2 L 36 MM	...002998
Ø 4.2 L 38 MM	...003001
Ø 4.2 L 40 MM	...003018
Ø 4.2 L 45 MM	...003025
Ø 4.2 L 50 MM	...003032
Ø 4.2 L 55 MM	...003049
Ø 4.2 L 60 MM	...003056



UTILISATION

Arthrodèse, synthèse
de fragments osseux.

MATÉRIAU

Titane TA6V ELI ISO5832-3

INSTRUMENTS ASSOCIÉS

KIT F.A.S.T.® AVANT MÉDIO PIED : VASEAMP / KIT F.A.S.T.® MÉDIO ARRIÈRE PIED : VASEMAP

Poignée à encliquetage AO



Jauge broche :
Recto pour broche 120 mm



Broche Ø 1.2 - L 120 mm



Tournevis Torx T10



Fraise à chambrer Ø 4.2

F.A.S.T.®

Ø 6.5




UTILISATION

Ostéotomie calcanéenne,
arthrodèse sous-talienne,
arthrodèse de cheville.

MATÉRIAU

Titane TA6V ELI ISO5832-3

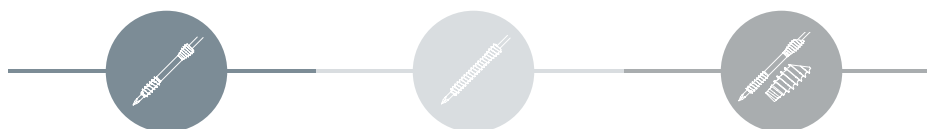

Les vis F.A.S.T.® Ø 6.5 sont dédiées à la chirurgie de l'arrière pied et se déclinent en 3 versions : Compression, Neutralisation et Biseautée. Cette vis a été développée pour répondre spécifiquement aux arthrodèses de cheville sous arthroscopie ou ciel ouvert. Elles sont guidées par une broche Ø 2.2 L 230 mm.

COMPRESSION		NEUTRALISATION		BISEAUTÉE	
LIBELLÉ	GS1	LIBELLÉ	GS1	LIBELLÉ	GS
FAST	3663165...	FAST	3663165...	FAST	3663165...
Ø 6.5 L 40 MM	...003063	Ø 6.5 L 40 MM	...003193	Ø 6,5 L 40 MM	...004596
Ø 6.5 L 45 MM	...003070	Ø 6.5 L 45 MM	...003209	Ø 6,5 L 45 MM	...004602
Ø 6.5 L 50 MM	...003087	Ø 6.5 L 50 MM	...003216	Ø 6,5 L 50 MM	...004619
Ø 6.5 L 55 MM	...003094	Ø 6.5 L 55 MM	...003223	Ø 6,5 L 55 MM	...004626
Ø 6.5 L 60 MM	...003100	Ø 6.5 L 60 MM	...003230	Ø 6,5 L 60 MM	...004633
Ø 6.5 L 65 MM	...003117	Ø 6.5 L 65 MM	...003247	Ø 6,5 L 65 MM	...004640
Ø 6.5 L 70 MM	...003124	Ø 6.5 L 70 MM	...003254	Ø 6,5 L 70 MM	...004657
Ø 6.5 L 75 MM	...003131	Ø 6.5 L 75 MM	...003261	Ø 6,5 L 75 MM	...004664
Ø 6.5 L 80 MM	...003148	Ø 6.5 L 80 MM	...003278	Ø 6,5 L 80 MM	...004671
Ø 6.5 L 85 MM	...003155	Ø 6.5 L 85 MM	...003285	Ø 6,5 L 85 MM	...004688
Ø 6.5 L 90 MM	...003162	Ø 6.5 L 90 MM	...003292	Ø 6,5 L 90 MM	...004695
Ø 6.5 L 95 MM	...003179	Ø 6.5 L 95 MM	...003308		
Ø 6.5 L 100 MM	...003186	Ø 6.5 L 100 MM	...003315		

INSTRUMENTS ASSOCIÉS

KIT F.A.S.T.® MEDIO ARRIÈRE PIED : VASEMAP

Poignée encliquetage 1/4 Carrée




Tournevis Torx T25




Fraise à chamber Ø 6.5



Broche Ø 2.2 - L 230 mm



Jauge broche :
Verso pour broche 230 mm



VIS SÉCABLE

Ø 2

Les vis sécables Ø 2 permettent la fixation des fragments osseux lors d'ostéotomie de Weil. Elles se mettent en place au moteur à l'aide d'adaptateur spécifique.

VIS SÉCABLES Ø 2 MM

DIMENSIONS	GS1
FAST	3663165...
2 X 11 MM	...001663
2 X 12 MM	...001670
2 X 13 MM	...001687
2 X 14 MM	...001694



UTILISATION

Ostéotomie de Weil

MATÉRIAU

Titane TA6V ELI ISO5832-3

INSTRUMENTS ASSOCIÉS

COMPLÉMENT DE POSE VIS SÉCABLE : VASECMP1

Adaptateur Mini AO Long



Tube de rangement



Tournevis d'ablation



ANCILLAIRE AMP

AVANT MEDIO PIED



ANCILLAIRE AMP

UTILISATION


Ancillaire AMP, compact, complet et polyvalent pour la chirurgie de l'avant et du médio pied.

KIT F.A.S.T.® AVANT MEDIO PIED : VASEAMP

LIBELLÉ	GSI
	3663165...
TOURNEVIS TORX T7	...003377
TOURNEVIS TORX T8	...003384
TOURNEVIS TORX T10	...003391
FRAISE À CHAMBRER Ø 2.3 MM	...003414
FRAISE À CHAMBRER Ø 2.7 MM	...003421
FRAISE À CHAMBRER Ø 3.2 MM	...003438
FRAISE À CHAMBRER Ø 4.2 MM	...003445
BROCHE Ø 1 - L 80 MM	...003469
BROCHE Ø 1.2 - L 120 MM	...003476
POIGNEE ENCLIQUETAGE AO	...003490
JAUGE BROCHE L80 / L 120 MM	...003513

OPTIONNEL

DAVIER SCARF	...000901
FORET CANULE VIS Ø 2.3 MM	...003599
FORET CANULE VIS Ø 2.7 MM	...003605
FORET CANULE VIS Ø 3.2 MM	...003612
FORET CANULE VIS Ø 4.2 MM	...003629
FORET PLEIN VIS Ø 2.3 MM	...003643
FORET PLEIN VIS Ø 2.7 MM	...003650
FORET PLEIN VIS Ø 3.2 MM	...003667
FORET PLEIN VIS Ø 4.2 MM	...003674

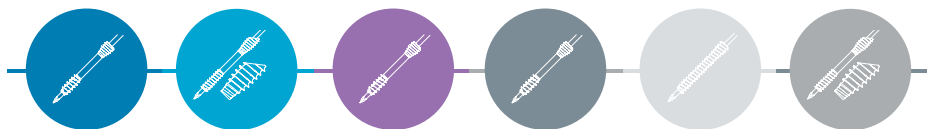

ANCILLAIRE MEDIO ARRIERE PIED **MAP**



ANCILLAIRE MAP

LIBELLÉ	GS1
	3663165...
TOURNEVIS TORX T10	...003391
TOURNEVIS TORX T25	...003407
FRAISE À CHAMBRER Ø 3.2 MM	...003438
FRAISE À CHAMBRER Ø 4.2 MM	...003445
FRAISE À CHAMBRER Ø 6.5 MM	...003452
BROCHE Ø 1.2 - L120 MM	...003476
BROCHE Ø 2.2 - L230 MM	...003483
POIGNEE ENCLIQUETAGE AO	...003490
POIGNEE ENCLIQUETAGE 1/4	...003506
JAUGE BROCHE L 80 MM / L 120 MM	...003513
JAUGE BROCHE L 230 MM	...003520
ADAPTATEUR JACOB-1/4	...003537

OPTIONNEL


FORET CANULE VIS Ø 3.2 MM	...003612
FORET CANULE VIS Ø 4.2 MM	...003629
FORET CANULE VIS Ø 6.5 MM	...003636
FORET PLEIN VIS Ø 3.2 MM	...003667
FORET PLEIN VIS Ø 4.2 MM	...003674
FORET PLEIN VIS Ø 6.5 MM	...003681

UTILISATION

Ancillaire MAP, compact, complet et polyvalent pour la chirurgie de l'arrière et du médio pied.

KIT F.A.S.T.® MEDIO ARRIÈRE PIED :
VASEMAP

ANCILLAIRE EXTRACTION

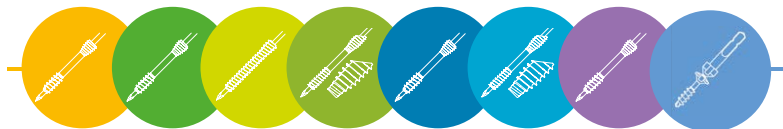

ANCILLAIRE EXTRACTION

UTILISATION

Le kit d'extraction F.A.S.T.® permet de retirer les vis Ø 2.3, Ø 2.7 Ø 3.2 et Ø 4.2 ainsi que les vis de plaques.

LIBELLÉ	GS1
	3663165...
TOURNEVIS TORX T7	...003377
TOURNEVIS TORX T8	...003384
TOURNEVIS TORX T10	...003391
TOURNEVIS TORX T7 PLEIN	...004558
TOURNEVIS TORX T8 PLEIN	...004565
TOURNEVIS TORX T10 PLEIN	...004572
BROCHE Ø 1 - L 80 MM	...003469
BROCHE Ø 1.2 - L 120 MM	...003476
POIGNEE ENCLIQUETAGE AO	...003476
TOURNEVIS ABLATION VIS Ø 2.0 MM	...000888

ANCILLAIRE D'EXTRACTION F.A.S.T.® : VASEXTRO



FRAISES PERCUTANÉES

Les fraises percutanées, instruments de base pour la chirurgie percutanée permettent de couper ou de surfacer les os.

FRAISES PERCUTANÉES

LIBELLÉ	GS1
	3663165...
SHANNON COURTE Ø 2 X 8 MM	...001144
SHANNON LONGUE Ø 2 X 12 MM	...001151
SHANNON ISHAM Ø 2 X 12 MM	...001168
SHANNON XL Ø 2 X 22 MM	...001175
WEDGE Ø 3 X 13 MM	...001182
WEDGE Ø 4 X 13 MM	...001199
PORTE LAME BEAVER	...000932



UTILISATION

Traitement de l'hallux valgus en percutanée, métatarsalgie.

MATÉRIAU

Acier inoxydable

INSTRUMENTS ASSOCIÉS

Lame Beaver



Porte lame beaver



Shannon Courte Ø 2 x 8 mm



Shannon Longue Ø 2 x 12 mm



Shannon Isham Ø 2 x 12 mm



Shannon XL Ø 2 x 22 mm




Wedge Ø 3




Wedge Ø 4

F.A.S.T.® TOE



Le Toe Fast permet d'apporter une réponse innovante à une pathologie récurrente de l'avant pied : la griffe d'orteil.

Les caractéristiques principales du TOE FAST sont une implantation vissée et clippée permettant un parfait maintien des phalanges.

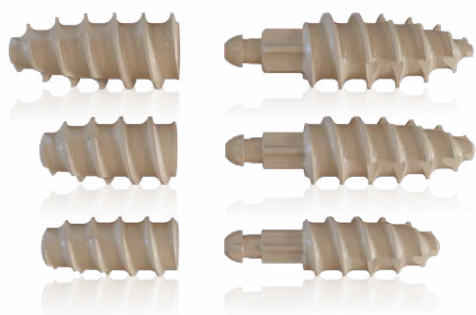

IMPLANTS

DIMENSIONS	GS1
	3663165...
TOE F.A.S.T.® TAILLE S	...004817
TOE F.A.S.T.® TAILLE M	...004824
TOE F.A.S.T.® TAILLE L	...004831

INDICATIONS

Griffes d'orteils



MATÉRIAU

PEEK



INSTRUMENTS ASSOCIÉS

KIT TOE F.A.S.T. : VASETFM

Poignée à encliquetage AO



Compacteur S / M




Tournevis mâle S / M / L



Tournevis femelle S / M / L



ANCILLAIRE TOE FAST

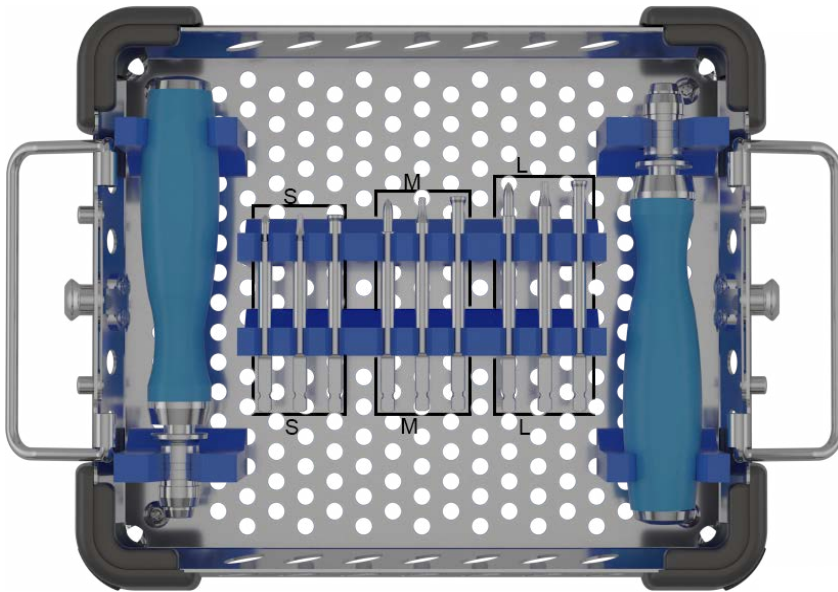

KIT TOE F.A.S.T.®

LIBELLÉ	GS1
	3663165...
PANIER TOE F.A.S.T.®	...004930
COUVERCLE TOE F.A.S.T.®	...004947
TOURNEVIS MÂLE TAILLE S	...004848
TOURNEVIS MÂLE TAILLE M	...004855
TOURNEVIS MÂLE TAILLE L	...004862
TOURNEVIS FEMELLE TAILLE S	...004879
TOURNEVIS FEMELLE TAILLE M	...004886
TOURNEVIS FEMELLE TAILLE L	...004893
COMPACTEUR TAILLE S	...004909
COMPACTEUR TAILLE M	...004916
COMPACTEUR TAILLE L	...004923
POIGNÉE ENCLIQUETAGE AO	...003490

F.A.S.T.®

PLAQUES



Les plaques F.A.S.T.® permettent de répondre aux principales indications dans la chirurgie de l'avant et du médio-pied. Elles peuvent recevoir 2 types de vis, verrouillées et non verrouillées en Ø 2.7 et 3.2.



35 mm 30 mm 30 mm 35 mm



30 mm 35 mm

F.A.S.T.® MTP

F.A.S.T.® SYNTHÈSE

LIBELLÉ	GS1		GS1
	3663165...		3663165...
GAUCHE STANDARD 35 MM	...004299	MINI 30 MM	...004220
DROITE STANDARD 35 MM	...004305	STANDARD 35 MM	...004237
GAUCHE MINI INVASIF 30 MM	...004312		
DROITE MINI INVASIF 30 MM	...004329		

UTILISATION

Ostéotomie, arthrodèse et fixation de fractures.

MATÉRIAU

Titane TA6V ELI ISO5832-3

INSTRUMENTS ASSOCIÉS

ANCILLAIRE F.A.S.T.® PLAQUES AVANT ET MEDIO PIED : VASEPLA

Poignée à encliquetage AO



Poignée à cliquet AO

Jauge Universelle :
Recto pour crochet / verso pour broche 120 mm



Broche Ø 1.6 - L 80 mm



Tournevis T10 préhenseur



F.A.S.T.® PLAQUES



45 mm

F.A.S.T.® REPRISE



35 mm

F.A.S.T.® BASALE

LIBELLÉ	GS1	LIBELLÉ	GS1
	3663165...		3663165...
MTP GAUCHE	...004367	3 MM	...004282
MTP DROITE	...004374	4 MM	...004275
		5 MM	...004268



18 mm

26 mm

30 mm


F.A.S.T.® UNIVERSELLE



35 mm

F.A.S.T.® LAPIDUS

LIBELLÉ	GS1	LIBELLÉ	GS1
	3663165...		3663165...
18 MM	...004336	2 MM	...004244
26 MM	...004343	3 MM	...004251
30 MM	...004350		



Foret gradué 10 - 30 court



Foret gradué 10 - 30 long



Fraise concave universelle



Fraise convexe universelle



Cintreuse



Élévateur MTP



Canon de perçage court



Canon de perçage long






Fantôme FAST
MTP 30 / 35



Fantôme FAST
Synthèse AMP 30 / 35

F.A.S.T.®

PLAQUES



UTILISATION

Ostéotomie, arthrodèse
et fixation de fractures.

MATÉRIAU

Titane TA6V ELI ISO5832-3

VIS Ø 2.7 MM

VERROUILLÉES		NON VERROUILLÉES	
LONGUEUR	GS1	LONGUEUR	GS1
	3663165...		3663165...
10 MM	...003780	10 MM	...004008
12 MM	...003797	12 MM	...004015
14 MM	...003803	14 MM	...004022
16 MM	...003810	16 MM	...004039
18 MM	...003827	18 MM	...004046
20 MM	...003834	20 MM	...004053
22 MM	...003841	22 MM	...004060
24 MM	...003858	24 MM	...004077
26 MM	...003865	26 MM	...004084
28 MM	...003872	28 MM	...004091
30 MM	...003889	30 MM	...004107

VIS Ø 3.2 MM

VERROUILLÉES		NON VERROUILLÉES	
LONGUEUR	GS1	LONGUEUR	GS1
	3663165...		3663165...
10 MM	...003896	10 MM	...004114
12 MM	...003902	12 MM	...004121
14 MM	...003919	14 MM	...004138
16 MM	...003926	16 MM	...004145
18 MM	...003933	18 MM	...004152
20 MM	...003940	20 MM	...004169
22 MM	...003957	22 MM	...004176
24 MM	...003964	24 MM	...004183
26 MM	...003971	26 MM	...004190
28 MM	...003988	28 MM	...004206
30 MM	...003995	30 MM	...004213

ANCILLAIRE PLAQUES

AVANT MEDIO PIED AMP



ANCILLAIRE PLAQUES

LIBELLÉ	GS1
	3663165...
POIGNÉE À CLIQUET AO	...004497
JAUGE UNIVERSELLE 10 - 30 MM	...004466
POIGNEE A ENCLIQUETAGE AO	...003490
ELEVATEUR MTP	...004480
CINTREUSE	...004473
TOURNEVIS T10 PRÉHENSEUR	...004381
FORET GRADUÉ 10 - 30 COURT	...004411
FORET GRADUÉ 10 - 30 LONG	...004428
CANON DE PERÇAGE COURT	...004442
CANON DE PERÇAGE LONG	...004459
FRAISE CONCAVE UNIVERSELLE	...004398
FRAISE CONVEXE UNIVERSELLE	...004404
BROCHE Ø 1.6 - L80 MM	...004435
FANTÔME FAST MTP 30	...004503
FANTÔME FAST MTP 35	...004510
FANTÔME FAST SYNTHÈSE AMP 30	...004527
FANTÔME FAST SYNTHÈSE AMP 35	...004534


UTILISATION

Ostéotomie, arthrodèse
et fixation de fractures.


MATÉRIAU

Titane TA6V ELI ISO5832-3

AGRAFES DE VARISATION



Les agrafe de varisations permettent la fixation des fragments osseux lors d'ostéotomie de phalangienne.



DROITE 90° - STÉRILE

DIMENSIONS	GS1
	3663165...
8 x 8 mm	...001724
10 x 10 mm	...001731

ANGULÉE 26° - STÉRILE

DIMENSIONS	GS1
	3663165...
8 x 8 mm	...001700
10 x 10 mm	...001717

UTILISATION
ostéotomie de Akin.

MATÉRIAU
Inox 316L ISO 5832-1

INSTRUMENTS ASSOCIÉS

KIT AGRAFE DE VARISATION VASEGAP

Porte-agraves impacteur 90°




Impacteur d'agrafe 90°



Broche Ø 1 - L 80 mm

ANCILLAIRE PLAQUES

AGRAFES DE VARISATION

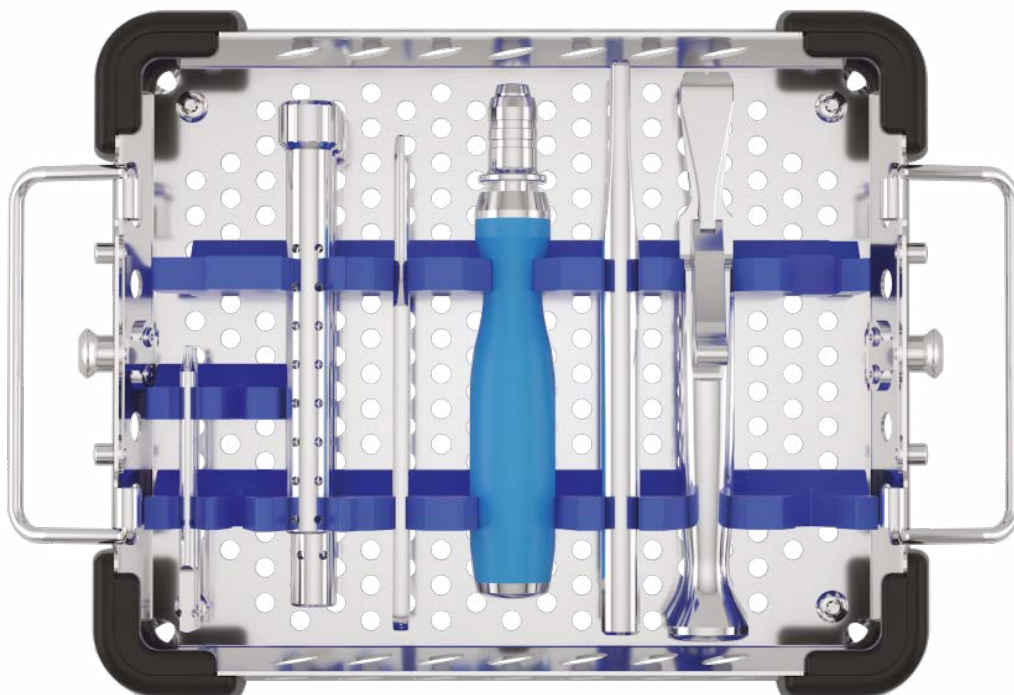

AGRAFES + VIS Ø 2.7


LIBELLÉ	GS1
	3663165...
PANIER AGRAFE VEOFIX	...004794
TOURNEVIS TORX T8	...003384
COUNTERSINK Ø 2.7	...003421
TUBE PERFORÉS BR L 120 MM	...003711
BROCHE Ø 1.2 - L 120 MM	...003476
TUBE PERFORÉ BR L 100 MM	...001915
BROCHE Ø 1 - L 80 MM	...003469
JAUGE BROCHE Ø 1 - L 80 MM / Ø 1.2 - L 120 MM	...003513
POIGNÉE ENCLIQUETAGE AO	...003490
IMPACTEUR D'AGRAFE 90°	...004763
PORTE-AGRAFE IMPACTEUR 90°	...004787

OPTIONNEL

LIBELLÉ	GS1
	3663165...
PORTE-AGRAFE 26°	...004770
TOURNEVIS TORX T7	...003377
COUNTERSINK Ø 2.3	...003414
TOURNEVIS TORX T10	...003391
COUNTERSINK Ø 3.2	...003438
DAVIER	...000901

UTILISATION

Ancillaire compact, complet et polyvalent. Il permet l'utilisation des agrafes de varisation ainsi que la pose de vis F.A.S.T.® Ø 2,7.

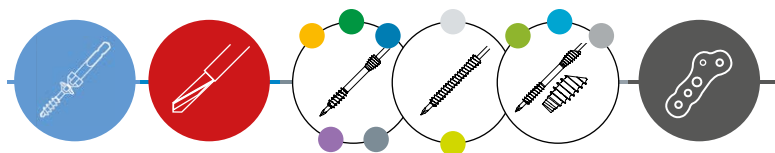

NOTICES D'INSTRUCTIONS

PRODUITS

HTTP://



Gamme de vis
FAST®

doc.serf.fr/0212.pdf



Vis sécables stériles
VEOFIX®

doc.serf.fr/0211.pdf



Fraises stériles
VEOFIX®

doc.serf.fr/0210.pdf



Toe FAST

doc.serf.fr/0214.pdf



Gamme de plaques
FAST®

doc.serf.fr/0213.pdf



Agrafes

doc.serf.fr/0209.pdf



NOTES



Distribué par

Tous les dispositifs médicaux mentionnés dans ce document sont marqués CE selon la Directive 93/42/CEE et ses amendements, à moins qu'identifiés spécifiquement comme « non marqués CE ».

Les dispositifs médicaux mentionnés dans ce document sont des dispositifs de classe IIb, IIa ou I.

Les dispositifs médicaux de classe IIb et IIa sont marqués CE 0459 avec le GMED.

Avant toute utilisation d'un produit SERF, veuillez-vous référer à la notice d'instructions et à la technique opératoire. Consulter les étiquettes et notices produits pour la liste complète des indications, contre-indications, risque, avertissement, précautions et mode d'emploi.

©2019 SERF. Tous droits réservés. F.A.S.T.® est une marque de commerce de SERF.

CE 0459



SERF
85 Avenue des Bruyères
69150 Décines-Charpieu - France
Tel. +33 (0)4 72 05 60 10

Distribué par

serf *extremity*